

灭蝇胺胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB091C01K

概要

灭蝇胺(Cyromazine)又名环丙氨嗪，一种昆虫生长调节剂类低毒杀虫剂，适用于多种瓜果蔬菜，主要对蝇类害虫具有良好的杀虫作用。

检测原理

本产品采用竞争抑制免疫层析原理，样本中的灭蝇胺与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体与 NC 膜检测线(T 线)上抗原的结合，从而导致 T 线颜色深浅的变化；根据 T 线与质控线（C 线）的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中灭蝇胺残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763。

检测限

0.5 mg/kg (ppm)

试剂盒组成

序号	规格 组成	10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡（1T/包）	10 卡	20 卡
(2)	稀释液（50mL/瓶）	1 瓶	2 瓶
(3)	5 mL 胶头滴管	1 支	1 支
(4)	20 mL 刻度样品杯	1 支	2 支
(5)	1.5 mL 离心管	10 支	20 支
(6)	说明书	1 份	1 份

注意事项

- (1) 检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗，避免交叉污染。
- (2) 样品要求：避免腐败变质样品；避免大块泥土（可以甩掉或用其他洁净物品擦除）。
- (3) 检测前建议样品充分搅拌均匀（若取样少则应取代表性部位，再进行称样），这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。
- (4) 检测环境温度应控制在 20~30℃，温度过高或过低会影响检测结果。
- (5) 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- (6) 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- (7) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- (8) 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (9) 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- (10) 加标验证时，标液溶剂一般选择甲醇，最终样本加标量建议在 10-50 μL。
- (11) 直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液，有机溶剂加入量控制在 1%以内，自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需妥善保存请，放在儿童不易接触的地方。
- (3) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (4) 本产品为一次性产品，检测完毕后应妥善处理，实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- (5) 本产品所涉及的试剂安全可靠，不含致癌性，剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂，但不得食用。

贮藏条件及有效期

- (1) 原包装：于 2-30℃避光干燥保存，勿冷冻，有效期 12 个月。
- (2) 拆封后：检测卡拆封后立即使用，勿冷冻。

灭蝇胺胶体金快速检测卡操作步骤

需自备的工具



天平 (精度0.01g)



剪刀



镊子



离心管



移液器 (0.2mL、1mL)



涡旋仪




计时器

样本前处理步骤

(1) 检测前样品需恢复至室温 (20-30℃)，取适量样本，剪切为 1 厘米见方的碎片。



(2) 称取 1 g 样品于样品杯或 15 mL 离心管中，加入 4 mL 稀释液。

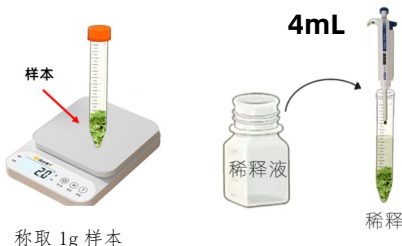

(3) 涡旋仪涡动或手动上下振摇 2 分钟，静置 1 分钟，得样品液；按下表将样品液与稀释液按不同比例稀释，稀释后的溶液为待测液。




不同样品的稀释方法及限量值


样品类别	样品名称	样品液(μL)+稀释液(μL)	国标限量 GB2763-2021
蔬菜类	豇豆、菜豆、食荚豌豆、扁豆、蚕豆、豌豆	无需稀释	0.5 mg/kg
	青花菜、黄瓜、茎用莴苣	100+100	1 mg/kg
	西葫芦、苦瓜	50+150	2 mg/kg
	葱、朝鲜蓟、甜椒	50+250	3 mg/kg
	叶用莴苣、结球莴苣、芹菜	20+140	4 mg/kg
	姜	20+260	7 mg/kg
	叶芥菜、丝瓜	20+380	10 mg/kg
水果类	芒果、瓜果类水果 (西瓜除外)	无需稀释	0.5 mg/kg

样本检测步骤

(1) 从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。




(2) 用移液器或滴管吸取 100 μL (约 3 滴) 待测液。




(3) 垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔中；液体流动时开始计时，反应 8~10 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。



结果判断



阴性



阳性



无效

目测：

阴性 (未检出)：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性 (检出)：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。