

甲氧苄啶胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB131R01K

概要

甲氧苄啶(Trimethoprim, TMP)作为抗菌增效药, 与磺胺类药物同时使用可使抗菌作用增强数倍至数十倍, 对畜禽疾病控制和治疗起到重要作用。目前已成为兽医临床和水产养殖中最重要的抗感染药物之一, 由于其耐药性和潜在的致癌性引起广泛的关注。本产品适用于企业、检测机构、监督部门等各类现场快速检测。

检测原理

本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成, 用于检测水产、畜禽组织样本中甲氧苄啶残留。样本溶液滴入检测卡的加样孔后, 样本溶液中的磺胺类药物与金标抗体相结合, 从而阻止金标抗体与纤维素膜上磺胺药物偶联物结合。根据 T 线与 C 线的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于水产、畜禽组织样本中甲氧苄啶残留的定性检测。

注: 检测样本种类参照国标 GB2763-2021。

检出限

甲氧苄啶检出限: 50 ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$)

试剂盒组成

序号	规格 组成	10 次/盒	20 次/盒
(1)	检测卡(内含滴管、干燥剂)	10份	20份
(2)	甲氧苄啶稀释液	1瓶	2瓶
(3)	15 mL离心管	1支	2支
(4)	1.5 mL离心管	10支	20支
(3)	说明书	1份	1份

注意事项

- (1) 每次检样前, 剪碎样本的刀具需进行清洗, 避免交叉污染。
- (2) 检测环境温度应控制在 20~30℃, 温度过高或过低, 将影响检测结果。
- (3) 请按照检测步骤进行测试, 操作时请勿触摸试纸条显色区, 避免阳光直射和电风扇直吹。
- (4) 样本处理后请尽快使用, 时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (5) 待检样品溶液需澄清, 否则容易导致显色不明显等异常现象, 影响实验结果判定。
- (6) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用, 拆封后的检测卡请立即使用。
- (7) 本产品为一次性产品, 请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。
- (8) 出现阳性结果时建议复测, 本产品检测结果仅供参考, 如需确证, 请参照国家相关标准方法。
- (9) 产品评价时, 若需直接检测标准品, 需用试剂盒内的专用稀释液配制。
- (10) 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方。
- (3) 实验所用全部物品, 应用完毕后应妥善处理。
- (4) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (5) 实验废弃物单独收集, 建议按照医疗废弃物处理。
- (6) 请勿食用配备的试剂。

贮藏条件及有效期

- (1) 贮藏条件: 2-30℃避光保存, 勿冷冻。
- (2) 有效期: 12 个月。

甲氧苄啶胶体金快速检测卡使用说明书

需自备的工具



天平 (精度0.01g)



剪刀



匀质器



离心机



镊子



离心管



移液器 (0.2mL、1mL)



涡旋仪




计时器

样本前处理步骤


(1) 取切碎的一定量的去脂肪水产或畜禽组织样品，用均质机均质。



(2) 称取约 1 克均质物于离心管中；加入 5 mL 稀释液。

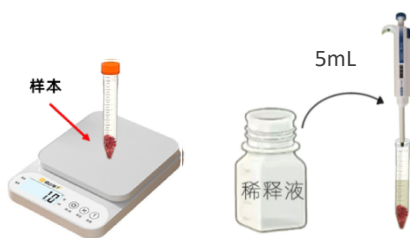


(3) 涡旋振荡 3 分钟，室温下 4000 转/分钟离心 3 分钟；用移液器移取 0.1ml 上清液（切勿吸取油脂）于 1.5ml 离心管中，加入 0.2ml 稀释液，平行轻摇混匀 30s，此混合液体即为待测液。

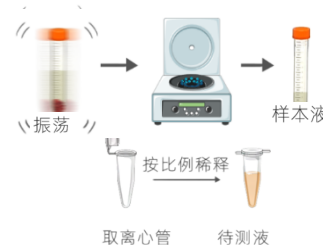


样本检测步骤

(1) 从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。




(2) 用移液器或滴管吸取 100 μ L (约 3 滴) 待测液。




(3) 垂直滴加到检测卡的加样孔中；液体流动时开始计时，8~10 分钟进行结果判定，其他时间判定无效。



结果判断



阴性



阳性



无效

目测：

阴性（未检出）：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。